



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0012193

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.312463 выдан 03 апреля 2018 г.
номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Государственному бюджетному учреждению Калининградской области «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны»; ИНН: 3904064652

РОССИЯ, Калининградская обл., г. Калининград, Московский пр-кт, 188
место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны»;

РОССИЯ, 236039, Калининградская обл., г. Калининград, Суворова, д.21
адрес места (мест) осуществления деятельности

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

соответствует требованиям

аккредитован(о) в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений; в соответствии с областью аккредитации, область аккредитаций определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
(Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице) 15 марта 2018 г.


М.П.

Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

О.И. Мальцев

инициала, фамилия

подпись

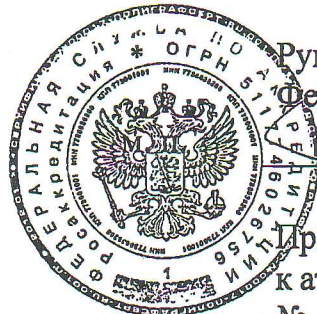

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

150318

№ РА.РУ.312463

от « 03 » апреля 20 18 г.

на 1 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Отряд
государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий
гражданской обороны» (ГБУ «ОГПС и ГО»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

236039, г. Калининград, ул. Суворова, 21

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

ГЗВ

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Приме- чание
		Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант				
1	Средства измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы фотонного излучения	0 - 0,5 Гр (0 - 50 рад) 0,10 мкГр/ч - 2,0 Гр/ч (0,01 мрад/ч - 200 рад/ч)	ПГ ± 15% ПГ ± 15%	
2	Средства измерений экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы фотонного излучения	0 - 50 Р 10 мкР/ч - 200 Р/ч	ПГ ± 10% ПГ ± 10%	
3	Средства измерений амбиентного эквивалента дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения	0,10 мкЗв - 10 Зв 0,10 мкЗв/ч - 2 Зв/ч	ПГ ± 10% ПГ ± 10%	
4	Радиометры плотности потока альфа-излучения	1,0 - 1·10 ⁴ см ⁻² мин ⁻¹	ПГ ± 15%	
5	Радиометры плотности потока бета-излучения	1,0 - 1·10 ⁶ см ⁻² мин ⁻¹	ПГ ± 15%	

Начальник ГБУ «ОГПС и ГО»

О.Д. Полищук

М.П.

Эксперт по аккредитации

В.А. Волков

